


氣瓶的內外部清潔作業,可歸類為以下幾種類別:

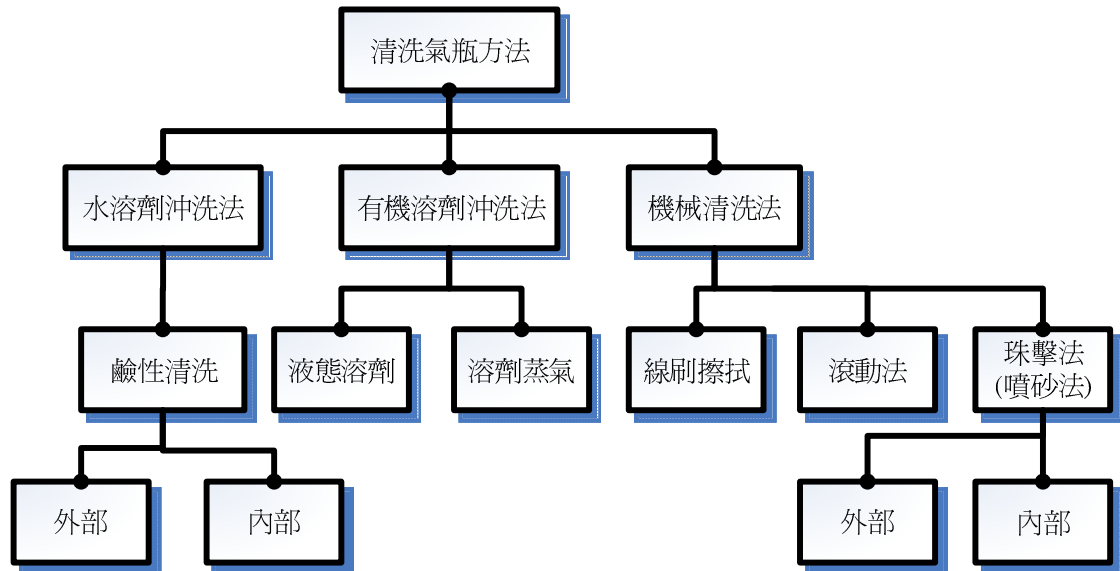

- 1.任何一種方法清洗後,都應用清水再沖洗及充分烘乾
- 2.沖洗醫用氣體氣瓶的清水必須符合飲用水標準
- 3.會對金屬產生侵蝕性的溶劑,不可使用於氣瓶清洗作業上
- 4.複合材料之氣瓶不可使用有機溶劑清洗
- 5.對於氣體清洗作業有任何疑問,請聯絡氣瓶之原製造商